

LUMIPOD



Замена расходных материалов

Пошаговая инструкция

Замена расходных материалов

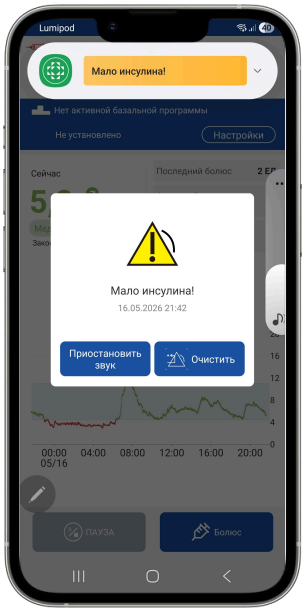

Стандартный **срок эксплуатации Lumiflex Lumipod** до смены инфузионного набора и резервуара — **3 дня**. По истечении этого срока требуется замена инфузионного набора и резервуара.

Запустите приложение

Шаг 1


Запустите приложение Lumipod на телефоне.

Шаг 2

Нажмите на значок **«Меню»** в верхнем углу.

Шаг 3


Выберите пункт **«Поменять резервуар»**.

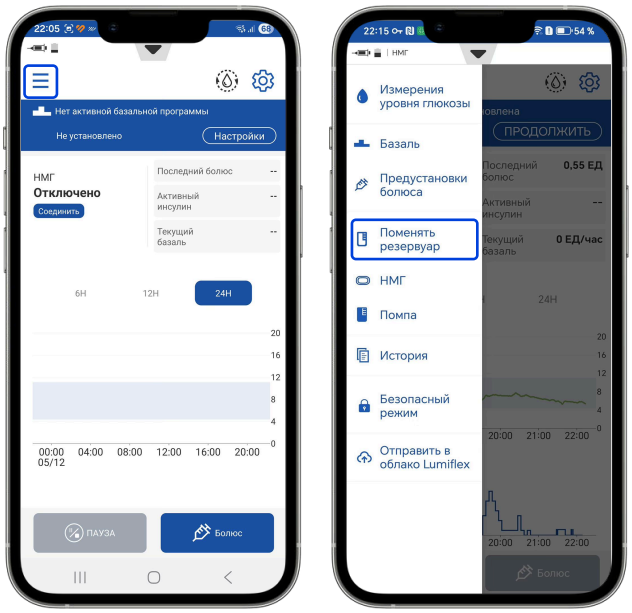

Снимите помпу

Шаг 1

Снимите помпу с фиксатора, следуя инструкции в приложении: сдвиньте ползунок в верхней части помпы, чтобы извлечь ее, и нажмите **«Далее»**.

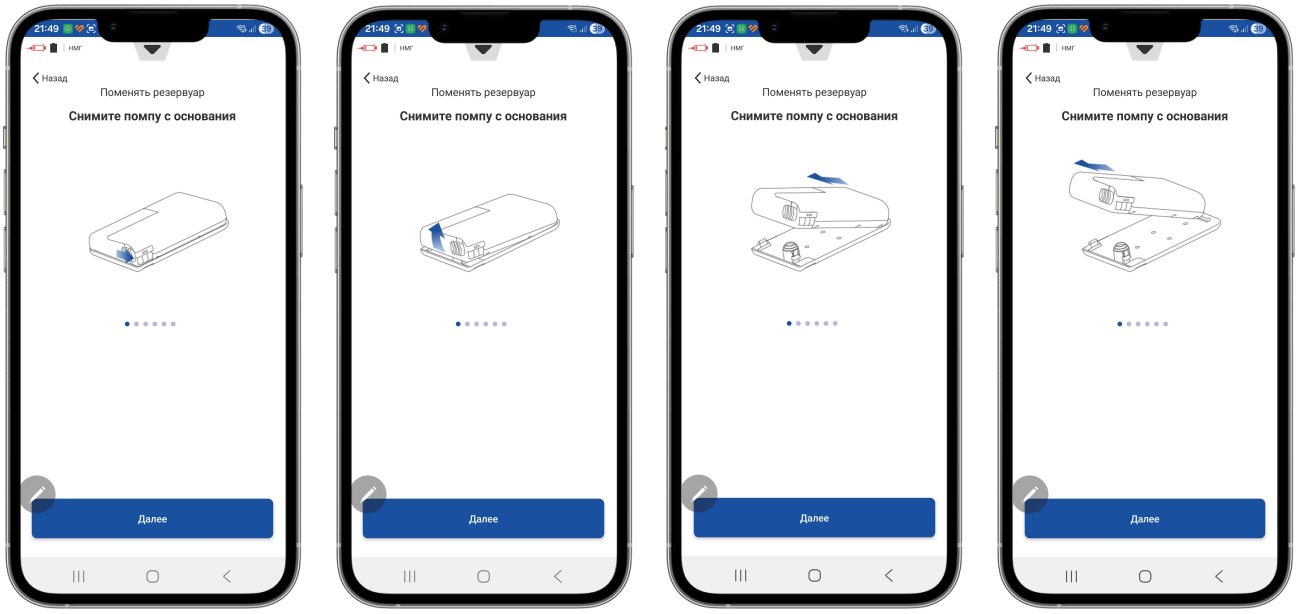



Шаг 2


Отсоедините край пластыря инфузионного набора, который установлен на тело. Продолжайте отделять пластырь от кожи, пока не будет удален инфузионный набор.

Перезапустите помпу

В приложении подтвердите обратный ход поршня, нажав **«Перезапустить»**.

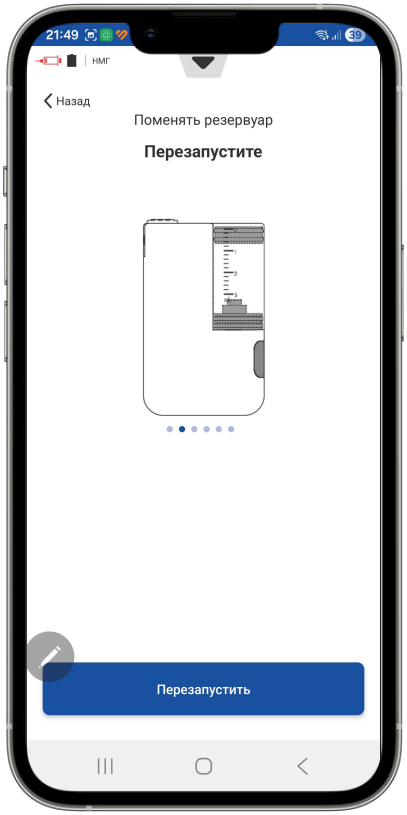

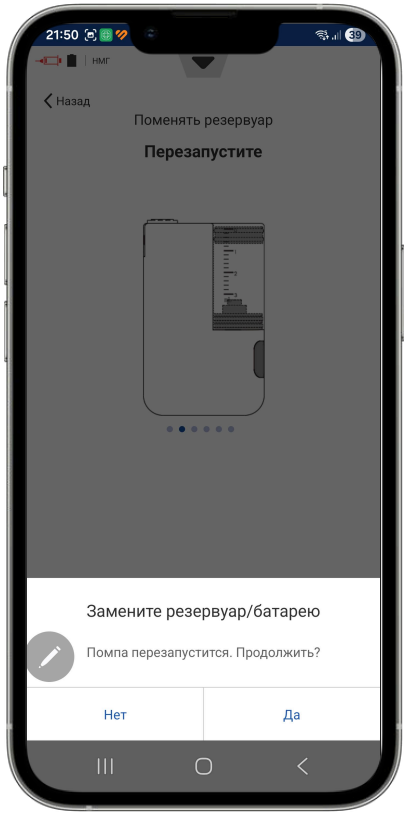

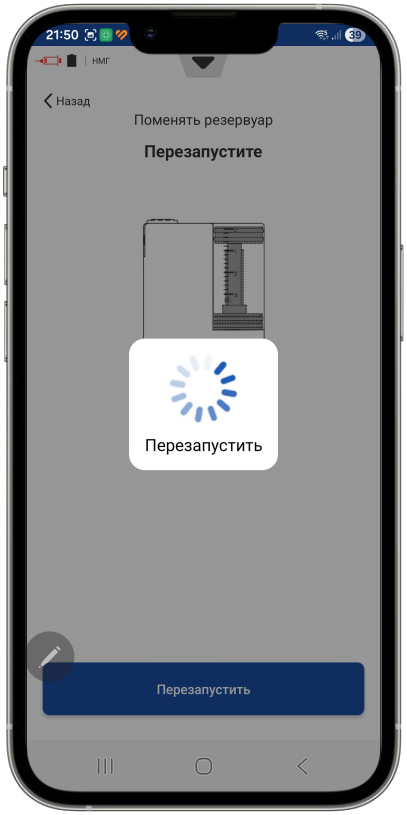

Зарядите помпу и заполните новый резервуар

Обратите внимание

- До установки инсулиновая помпа должна быть полностью заряжена, а инсулин должен быть комнатной температуры.
- Помпу необходимо заряжать с вставленным в нее использованным резервуаром.
- Не заряжайте помпу до полного использования инсулина, чтобы инсулин не потерял свою эффективность.
- Перезаряжайте помпу при каждой замене резервуара.
- Перед применением полностью заряженной помпы резервуар необходимо заменить на новый.

Установите новый инфузионный набор


При выборе места установки следуйте рекомендациям

- Предпочтительные места установки помпы в порядке убывания приоритета: Живот → Задняя поверхность плеча → Внешняя часть бедра → Поясница → Ягодицы.
- Важно избегать установки инфузионного набора на участки с уплотнениями и рубцами, а также на места, которые могут подвергаться механическому трению о другие предметы, такие как ремни, пояса или тесная одежда.

Важно!

- При наличии волос на выбранном участке их необходимо удалить.
- При установке инфузионного набора важно отступить **не менее 7,5 сантиметров** от сенсора системы непрерывного мониторинга глюкозы.
- Не устанавливайте новый инфузионный набор на то же место, где был установлен предыдущий, — чередуйте места установки!


Установите заполненный резервуар

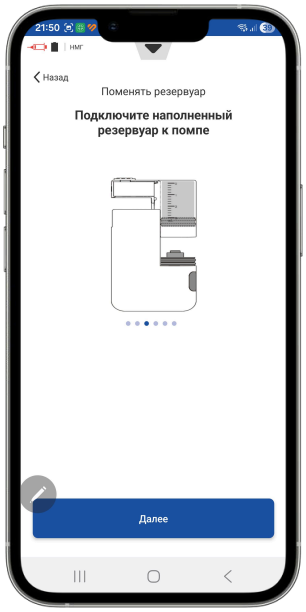



Перейдите в приложение и следуйте инструкциям по установке заполненного резервуара на экране. Затем нажмите **«Далее»**.


Заполните резервуар

Нажмите и удерживайте кнопку **«Заполнить»**, пока из кончика иглы резервуара не появится капля инсулина.

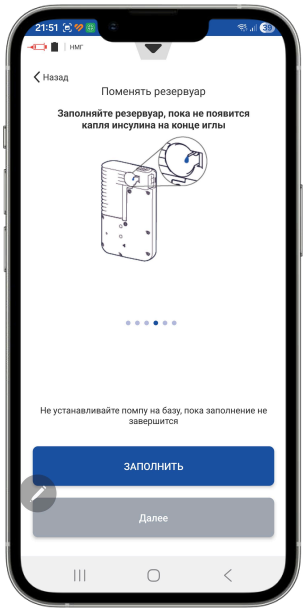

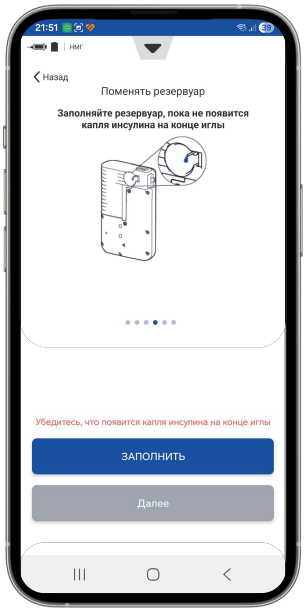


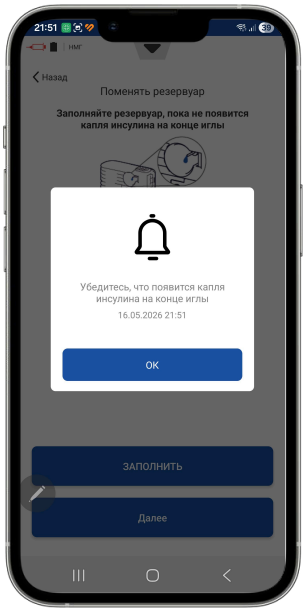

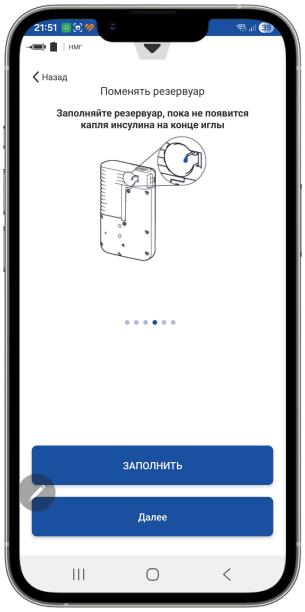



Установите помпу


1. Установите помпу на фиксатор, следуя инструкции в приложении.

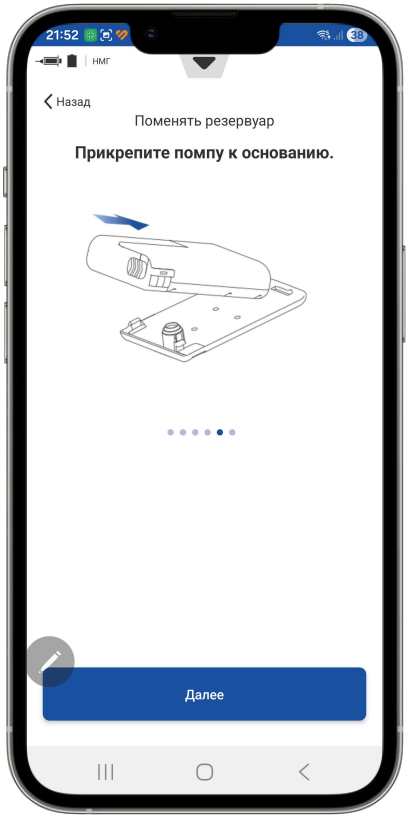



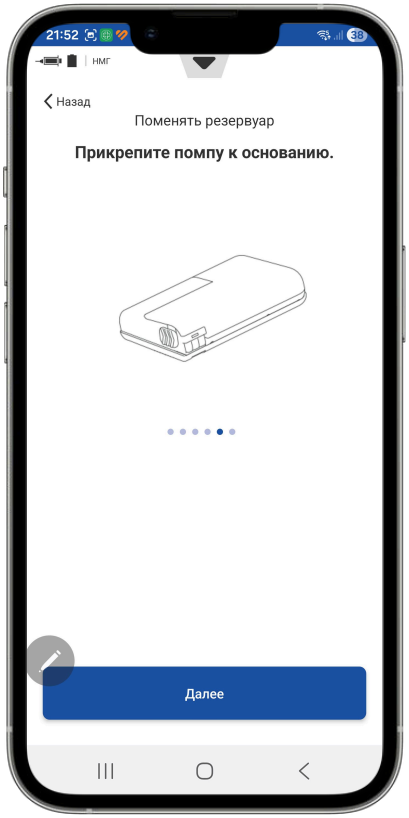


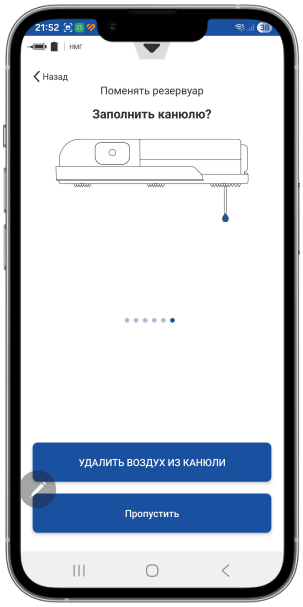

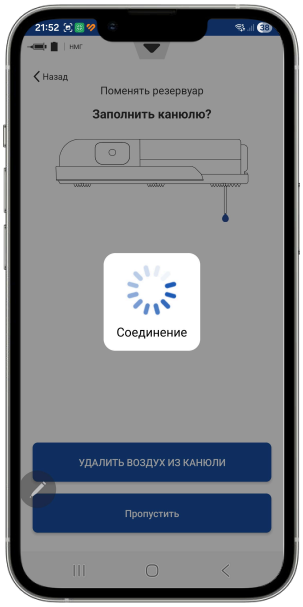

2. Вернитесь к приложению, нажмите **«Далее»** и выберите **«Удалить воздух из канюли»**.

Расходные материалы успешно заменены!

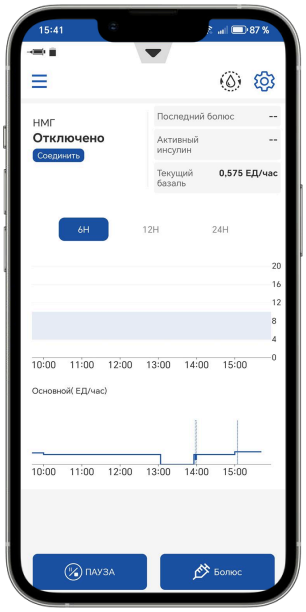

Теперь вы можете продолжить использование и перейти к настройкам работы помпы Lumiflex Lumipod.



LUMIFLEX

Для оперативной поддержки свяжитесь с нами

Поддержка в Telegram

Поддержка в MAX

lumipod@lumiflex.ru